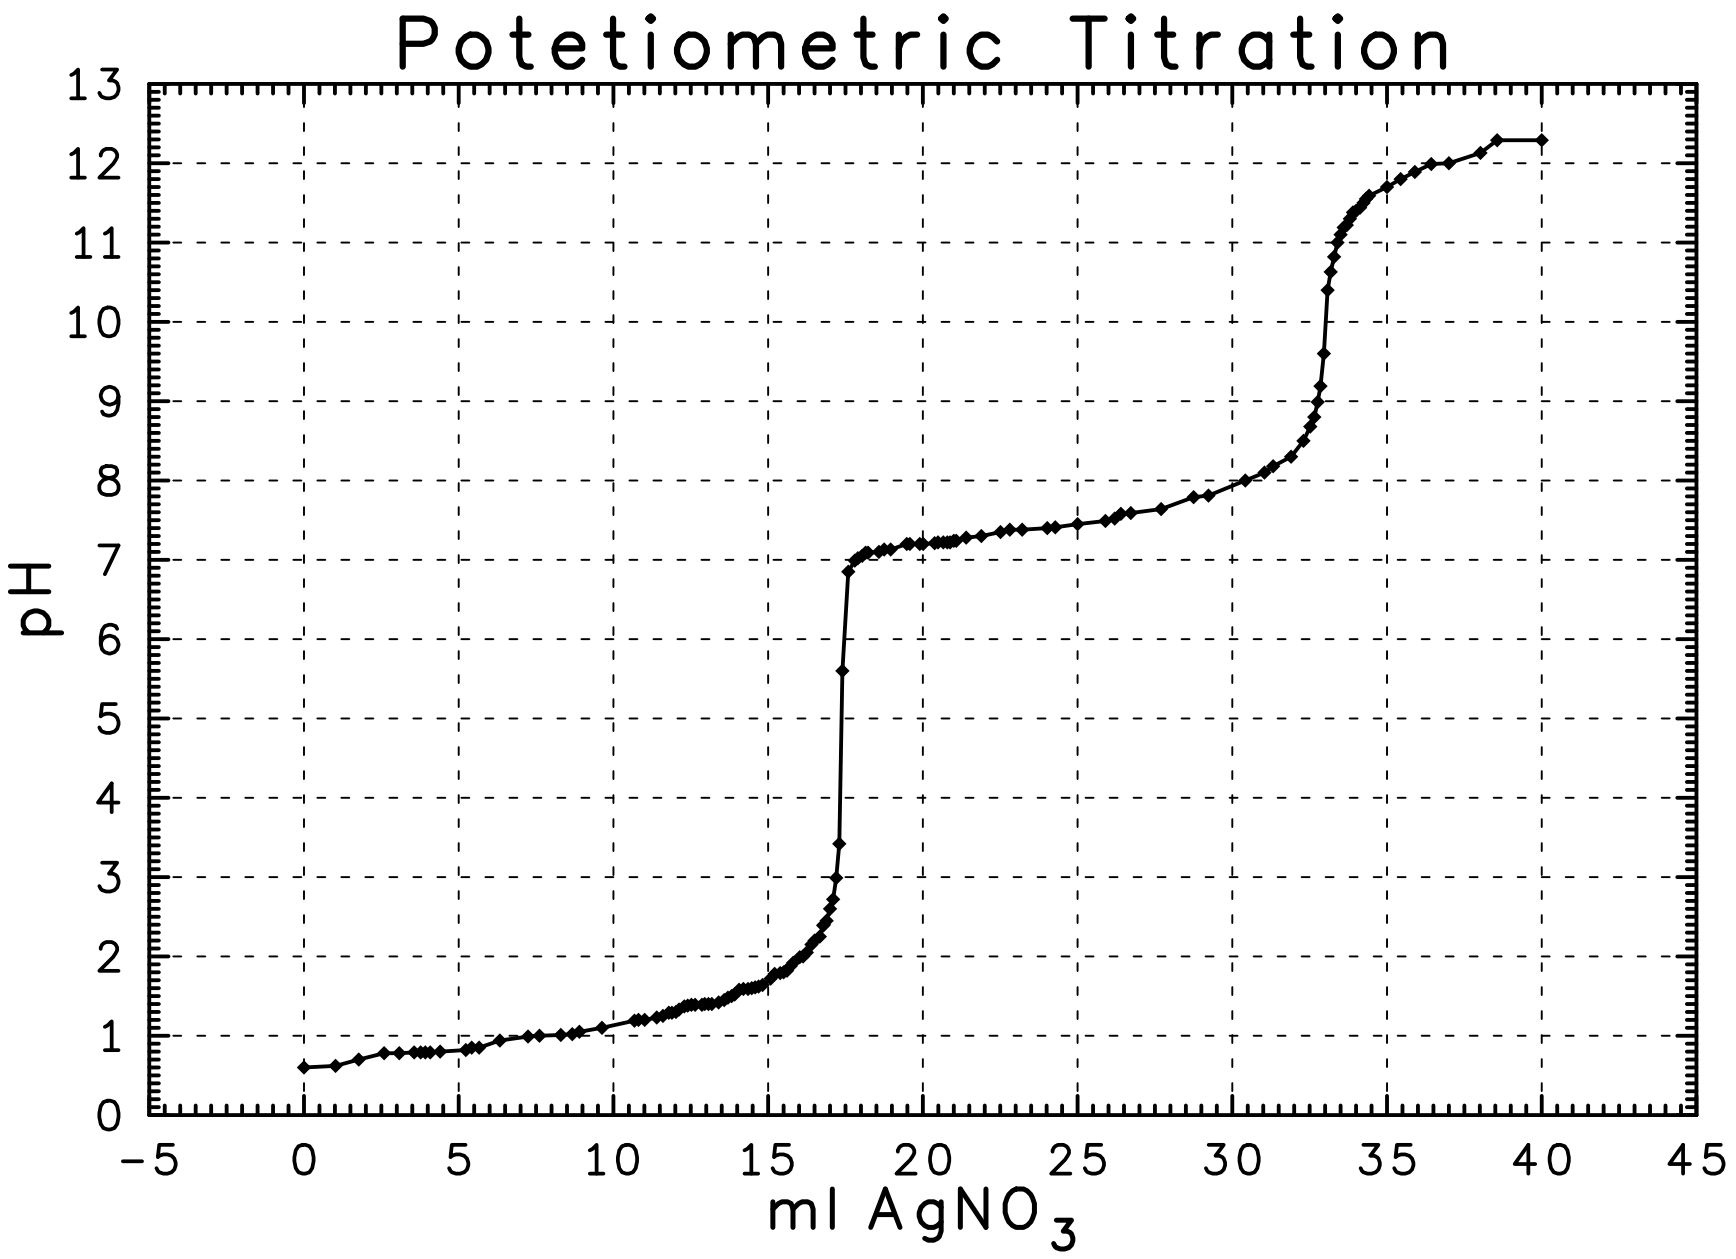
Potetiometric Titration
pH
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
ml AgNO3